


IR-SPEKTRUM-NR.:

0 2 0 4 3 2

Auftrag: Dr. J.S. Mickel

Probe: Vers. 59

Aufnahmetechnik: KBr-Pressl

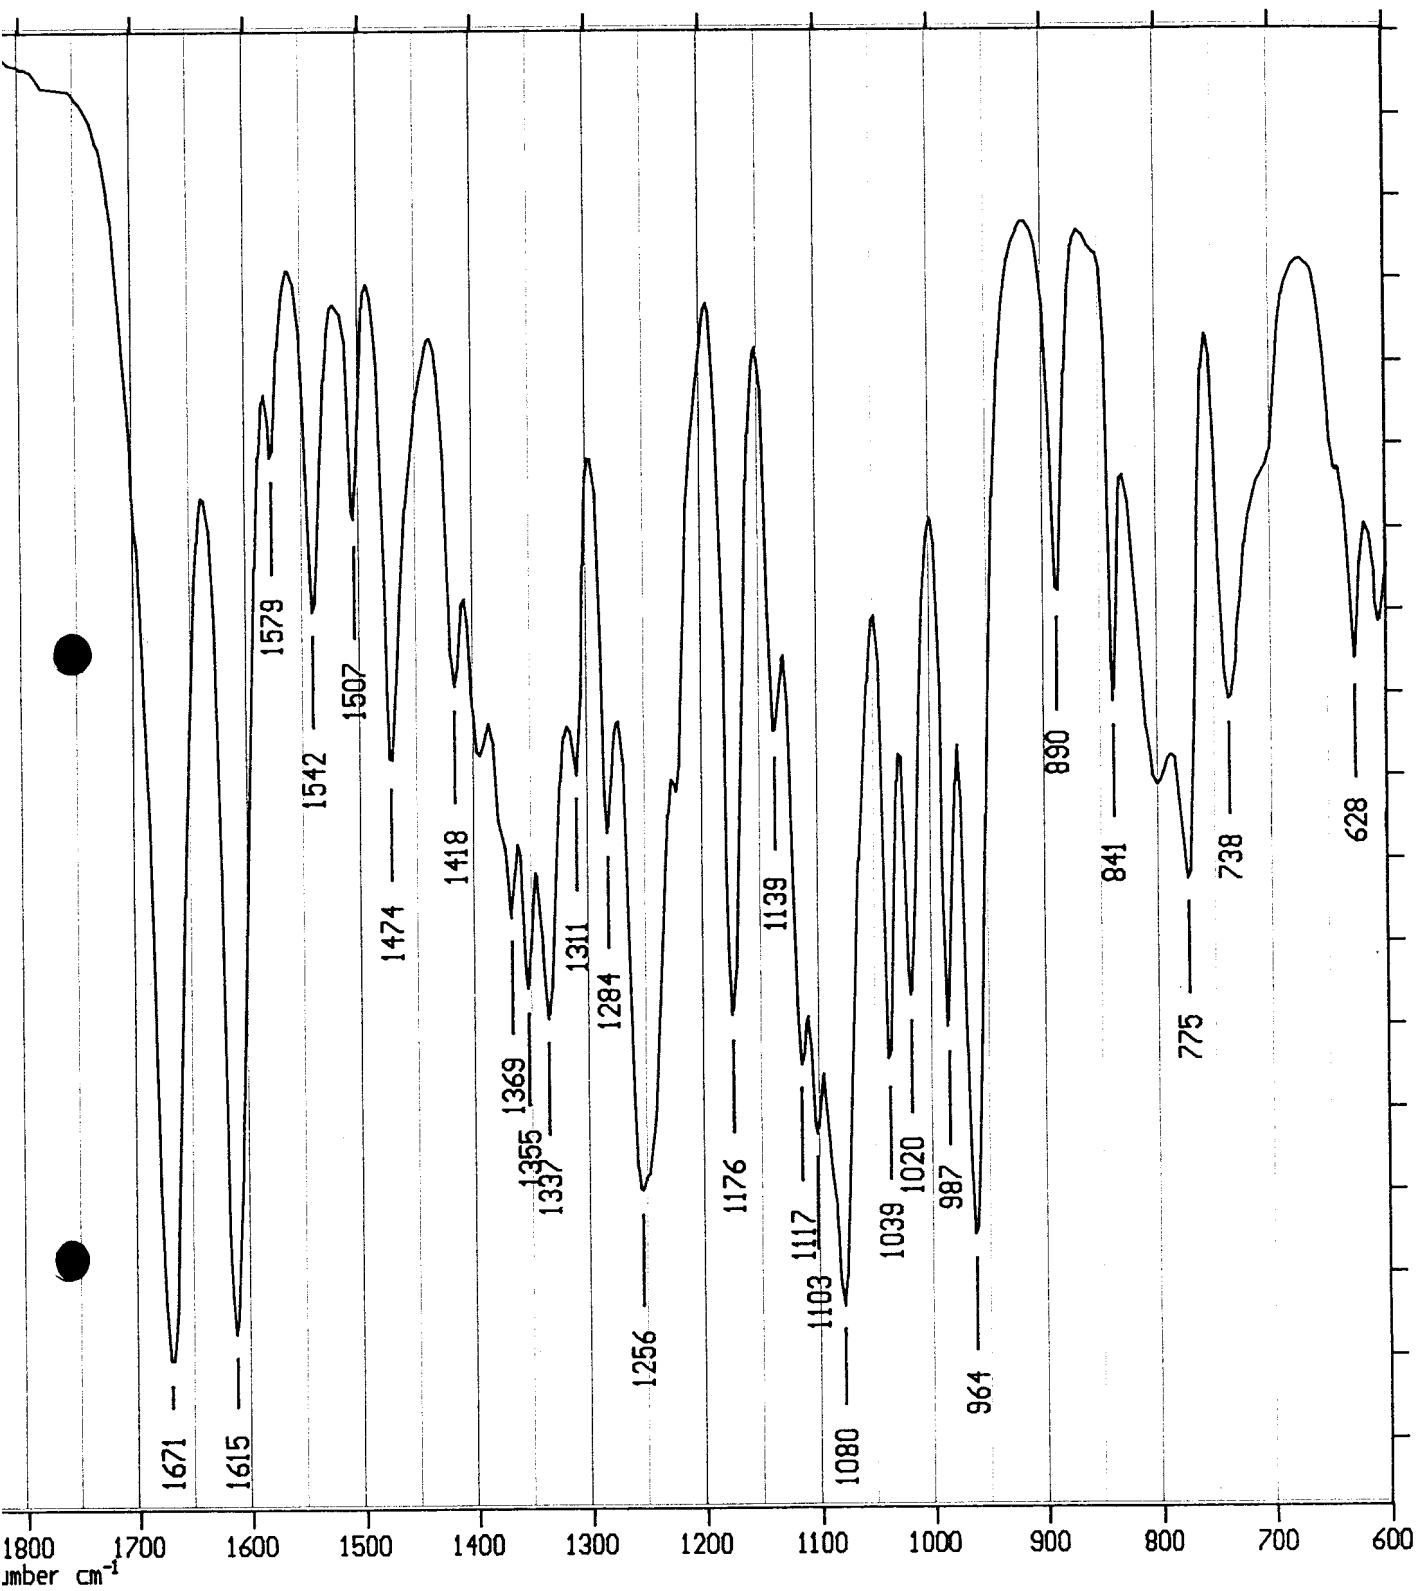

ig

Auflösung : 4.0  
Spiegelgeschwindigkeit : 9 ; 60.0 KHz  
Anzahl Messläufe : 128  
Datum : 15/ 6/1998